




型 式	L T - 1	
定 格 電 圧 (V)	100, 200, 415	
定 格 周 波 数 (Hz)	50/60共用	
測 定 範 囲	感 度 電 流 (mA)	50, 500 (2レンジ切替)
	動 作 時 間	999ms, 9.99s (2レンジ切替)
	使 用 周 囲 温 度	0℃～40℃
付 属 品	携帯用ケース	
	電 源 側 測 定 リード線	
	負 荷 側 測 定 リード線	
寸 法 (mm)	H175×W175×D100(携帯用ケースを含む)	
重 量 (kg)	2.1	
定 価 (円)	100, 500	
別 売 品	付 属 電 源 装 置 (LTS型)	 ¥63, 400

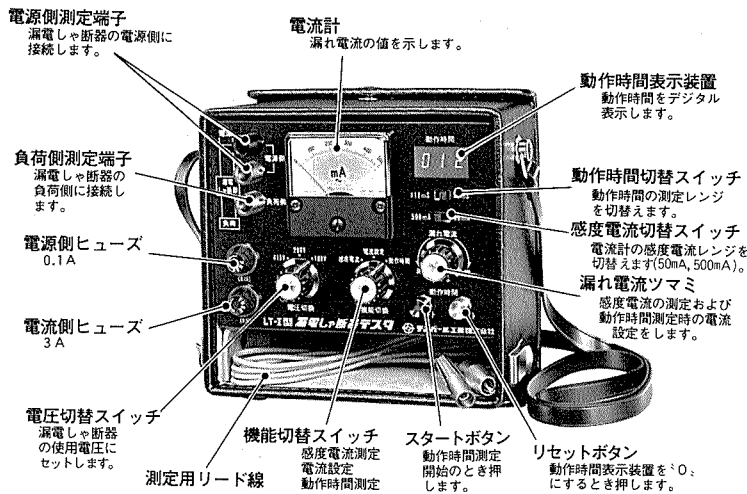

関係法令

〈労働安全衛生法〉

感電防止用漏電しゃ断装置の接続および使用の安全基準に関する技術上の指針(注: 抜萃につき詳細は法規集を参照願います。)

1. 総 則


1-1 趣 旨

この指針は、移動式または可搬式の電動機械器具(電動機を有する機械または器具をいう、以下同じ。)が接続される電路(商用周波数の交流であって対地電圧300V以下の電路に限る、以下同じ。)に接続する電流動作形の感電防止用漏電しゃ断装置(以下「しゃ断装置」という。)の適正な接続および使用を図るため、これらに関する留意事項について規定したものである。

4-2 定期の測定

(1) しゃ断装置については、定期に、次の表の左欄に掲げる事項について、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により測定を行なうこと。

定格感度電流——しゃ断装置用テストを用い、または次の図に示す方法により測定すること。



動作時間——しゃ断装置用テストを用い、または図1および図2に示す方法により測定すること。

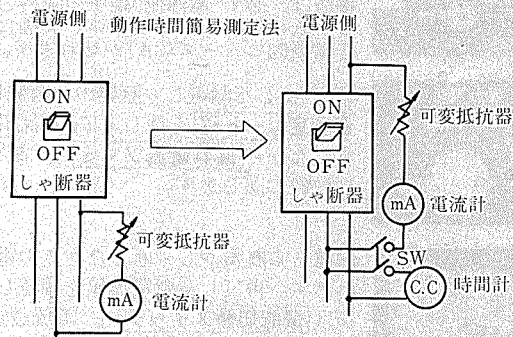


図1 可変抵抗器をしゃ断器の定格感度電流に設定する。

図2 動作時間を測定する。

